

SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI
BỆNH VIỆN NHI

Số: 132/BVN-VTTBYT
V/v yêu cầu báo giá mua sắm
Giường bệnh nhân loại 1 tay quay.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 18 tháng 02 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023 của Quốc hội khoá 15;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKĐT ngày 26 tháng 04 năm 2024 Hướng dẫn về việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Biên bản họp ngày 17/02/2025 của Hội đồng khoa học Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai về việc thống nhất danh mục, chủ trương thực hiện mua sắm Giường bệnh nhân loại 1 tay quay;

Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm Giường bệnh nhân loại 1 tay quay với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư-TBYT, Số điện thoại: (0269).3797922, Email: pvtbtyt.bvnhi.gl@gmail.com.
- Cách thức tiếp nhận báo giá (Bản gốc):

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư-TBYT Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, Thôn 6, xã Trà Đa, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai (Các hãng sản xuất, nhà cung cấp có thể gửi trước bản scan báo giá qua địa chỉ email nêu trên).

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 18 tháng 02 năm 2025 đến trước 17h ngày 28 tháng 02 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 28 tháng 02 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục mua sắm Giường bệnh nhân loại 1 tay quay, yêu cầu các hãng sản xuất báo giá với nội dung cụ thể như sau: (có danh mục phụ lục kèm theo).



2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: tại kho phòng Vật tư – Thiết bị y tế Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, Thôn 6, xã Trà Đa, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.


4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng

- Không tạm ứng.
- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản 100%
- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 120 ngày kể từ ngày bên mua nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán theo quy định

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VTTBYT;
- Lưu website Bệnh viện.

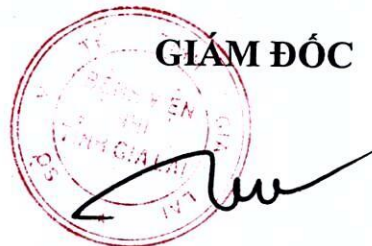

Đặng Hữu Chiến



PHỤ LỤC

(Kèm theo yêu cầu báo giá số: 132/BVN-VTTBYT ngày 18/02/2025 của Bệnh Viện Nhi tỉnh Gia Lai)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
1	GIƯỜNG BỆNH NHÂN LOẠI 1 TAY QUAY	YÊU CẦU CHUNG - Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở về sau, mới 100%. - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng CE, ISO 13485 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ: +5°C ~ +50°C. + Độ ẩm: ≤ 85%. YÊU CẦU CẤU HÌNH - Khung giường chính: 01 bộ - Bánh xe có phanh hãm, có nắp bọc che bụi bẩn: 04 cái - Giá truyền dịch 4 móc: 01 cái - Nệm giường: 01 cái - Tay cầm tay quay: 01 cái - Tài liệu HDSD Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 1. Quy cách: (±1% sai số) - Tổng thể: Dài 2160 x Rộng 960mm - Mặt giường: Dài 1960 x Rộng 860mm - Chiều cao: 510mm - Tải trọng khoảng: ≥260kg. 2. Tính năng kỹ thuật: hoặc ưu việt hơn <i>*Mặt giường:</i> - Nâng hạ đầu từ: khoảng từ 0 độ đến 85 độ (±1% sai số) - Có khóa để tháo rời tấm chắn - Làm bằng thép tấm cán nguội chất lượng cao chống ăn mòn được dập thành hình và hàn liền mạch, phủ hai lớp bột polyester hoàn thành. - Thiết kế chống kẹp ngón tay. Tấm thép cán nguội được dập và kéo căng, có lỗ thông hơi thoáng khí, độ dày tấm ≥1.5mm. - Mặt tấm sử dụng đầu nối kết hợp thép cường độ cao (độ dày nhúng ≥3mm), với bu lông trực đường kính ≥8mm được cố định bằng đai ốc khóa.	Châu Á	Cái	46

- Mặt tấm có thể tháo rời để dễ dàng vệ sinh và bảo dưỡng.
- Có hiển thị thông số đo góc nâng hạ.

**Khung giường:*

- Kết cấu gia cố chống xoắn và căng.
- Mặt chính của khung giường trên làm bằng thép chịu lực hình chữ nhật.
- Kích thước: $\geq 30 \times 30 \times 1.5$ mm.
- Chân giường: Được hàn bằng ống thép: $\geq 20 \times 30 \times 1.5$ mm.

**Đầu giường/chân giường:*

- Sử dụng nhựa kỹ thuật ABS để đúc thổi một lần có tác dụng kháng khuẩn và chống nấm mốc.
- Có tấm chắn chống va chạm bảo vệ xung quanh 4 góc đầu giường/chân giường.
- Mối nối giữa đầu giường và khung giường được giấu bên trong đầu giường và được trang bị công tắc khóa. Cờ lê công tắc nối với khung giường được đúc bằng kim loại có độ bền cao.
- Đường kính tay cầm lỗ đầu giường phù hợp để cầm nắm.
- Khoảng hở của lỗ mở kín đầu giường và chân giường so với mặt giường ≤ 120 mm;

**Thanh chắn:*

- Chất liệu hợp kim sơn tĩnh điện, độ dày $\geq 1,5$ mm xử lý làm cứng bề mặt.
- Cột ống tròn hai mặt phẳng bằng thép không gỉ, quy trình hàn toàn bộ khớp nối hình chữ U bằng thép, độ dày $\geq 1,5$ mm, đinh tán chốt bằng thép không gỉ, dễ gấp.
- Để được làm bằng ống thép $\geq 30 \times 30 \times 1.5$ mm.
- Công tắc ray bên có chức năng chống kẹt và nhắc nhở chống kẹt.
- Chiều cao ≥ 300 mm so với bề mặt giường sau khi nâng lên. Chiều dài tổng thể của lan can: 1450mm ($\pm 1\%$ sai số).
- Cấu trúc kết nối bu lông nhúng, được trang bị nắp bảo vệ.
- Dầm ray bên chịu trọng lực ≥ 800 N mà không bị biến dạng vĩnh viễn.

**Hệ thống tay quay truyền động:*

- Tay cầm gấp, có thể giấu dưới gầm giường. Tay quay có lõi thép tích hợp là vật liệu chống mài mòn chuyên nghiệp, kéo dài tuổi thọ.
- Cản trực dạng ống lồng được làm bằng thép không gỉ, khớp nối vạn năng bằng thép và vít dẫn là thép ren đôi thiết kế hình thang hoặc tương đương. Đảm bảo chức năng bảo vệ, giới hạn hai hướng, rung lắc linh hoạt và không gây tiếng ồn. Trục thanh giằng và thanh giằng được làm bằng ống thép cường độ cao để đảm bảo độ ổn định và không bị gãy.
- Khi đạt đến điểm cao nhất, sẽ có tín hiệu cảnh báo.

**Bánh xe:*

- Bánh xe có phanh riêng lẻ, đường kính ≥ 125 mm ($\pm 1\%$ sai số).



	- Bánh xe cao su nhân tạo siêu đàn hồi TPR, bề mặt phủ lớp nhựa ABS, chống thấm nước, chống bụi, dễ vệ sinh. Khả năng chịu tải trọng $\geq 150\text{kg/bánh}$. - Sử dụng ổ trục kín có chèn bên trong để quay, không cần dầu bôi trơn, giảm tiếng ồn hiệu quả, di chuyển dễ dàng, êm ái, chịu áp lực và chống mài mòn. - Có công tắc phanh tích hợp, có thể xoay 360 độ <i>*Nệm:</i> - Kích thước: Dài 1940 x Rộng 880 x dày 80mm ($\pm 1\%$ sai số) - Lớp ngoài: Được làm từ chất liệu canvas, chống thấm, thoáng khí - Lớp trong: Được làm bằng mút PE - Nệm dày 6cm <i>*Giá truyền dịch 4 móc:</i> - Chiều cao: 800-1400mm ($\pm 1\%$ sai số). Chất liệu Inox YÊU CẦU KHÁC: - Sản phẩm mới 100% - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng, hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.			
--	---	--	--	--

