

SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI
BỆNH VIỆN NHI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 301/BVN-VTTBYT

Gia Lai, ngày 02 tháng 4 năm 2025

V/v yêu cầu báo giá Hệ thống chuyển đổi X-Quang kỹ thuật số cho Hệ thống X-quang cao tần ≥ 320 mA (Model: MS325HFLC STR; Hãng/nước sản xuất: Control-x/Mỹ) và màn hình cảm ứng cho Hệ thống siêu âm Doppler màu chuyên tim mạch, 02 đầu dò máy in màu+ đen trắng (Model: Acuson NX3 Elite; Hãng/nước sản xuất: Siemens/Hàn Quốc) của Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai năm 2025.

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Biên bản họp ngày 01/4/2025 của Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai về việc thống nhất chủ trương nâng cấp hệ thống chuyển đổi X-Quang kỹ thuật số cho Hệ thống X-quang cao tần ≥ 320 mA (Model: MS325HFLC STR; Hãng/nước sản xuất: Control-x/Mỹ) và mua sắm màn hình cảm ứng cho Hệ thống siêu âm Doppler màu chuyên tim mạch, 02 đầu dò máy in màu+ đen trắng (Model: Acuson NX3 Elite; Hãng/nước sản xuất: Siemens/Hàn Quốc) của Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai năm 2025.

Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán “Mua sắm: Hệ thống chuyển đổi X-Quang kỹ thuật số cho Hệ thống X-quang cao tần ≥ 320 mA (Model: MS325HFLC STR; Hãng/nước sản xuất: Control-x/Mỹ) và màn hình cảm ứng cho Hệ thống siêu âm Doppler màu chuyên tim mạch, 02 đầu dò máy in màu+ đen trắng (Model: Acuson NX3 Elite; Hãng/nước sản xuất: Siemens/Hàn Quốc) của Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai năm 2025” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư Thiết bị y tế Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Địa chỉ: Thôn 6, xã Trà Đa, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam;

SĐT: 02693 797922;

Email: pvtbtyt.bvnhigl@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá (Bản gốc):

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư -TBYT Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, Thôn 6, xã Trà Đa, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam (Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi trước bản scan báo giá qua địa chỉ email nêu trên).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 17h00 ngày 03 tháng 4 năm 2025 đến trước 09h 00 ngày 14 tháng 4 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục yêu cầu báo giá:

(Có phụ lục 1 kèm theo)

Lưu ý:

► Theo điểm D Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định về một trong các căn cứ xác định giá gói thầu như sau: “d) Tối thiểu 01 báo giá của hàng hóa, dịch vụ; khuyến khích thu thập nhiều hơn 01 báo giá; trường hợp có nhiều hơn 01 báo giá thì lấy giá trung bình của các báo giá.

Đối với gói thầu mua thuốc; hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị y tế: trên cơ sở yêu cầu chuyên môn, chủ đầu tư quyết định các tiêu chí kỹ thuật và tổ chức lấy báo giá. Chủ đầu tư đăng tải yêu cầu báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc trên cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của chủ đầu tư hoặc Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế hoặc Cổng dịch vụ công trực tuyến về quản lý thiết bị y tế trong thời gian tối thiểu 10 ngày kể từ ngày thông tin đăng tải thành công. Trường hợp có từ 02 báo giá trở lên, chủ đầu tư được lựa chọn báo giá cao nhất phù hợp với khả năng tài chính và yêu cầu chuyên môn. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thu thập báo giá bảo đảm công khai, minh bạch. Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá;”, ► Theo Khoản 32 Điều 2 Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ: “32. Thay thế cụm từ “trường hợp có nhiều hơn 01 báo giá thì lấy giá trung bình của các báo giá” bằng cụm từ “trường hợp có nhiều hơn 01 báo giá thì được lấy giá trung bình của các báo giá” tại điểm d khoản 2 Điều 16, bệnh viện yêu cầu Quý nhà thầu cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình, giá chào là giá do nhà thầu tự cân đối tất cả các chi phí liên quan dựa trên thông số kỹ thuật, cấu hình mà nhà thầu chào và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin do mình cung cấp.



► ***Yêu cầu các hãng sản xuất, nhà cung cấp vui lòng báo giá theo Mẫu báo giá tại phụ lục 2 đính kèm.***

2. Địa điểm cung cấp lắp đặt, yêu cầu về vận chuyển, bảo quản như sau:

- Địa điểm cung cấp: kho Phòng Vật tư- TBYT, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai; Thôn 6, xã Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

- Nhà thầu chào giá với Mức giá đã bao gồm tất cả các loại thuế, các loại phí và chi phí vận chuyển đến kho Phòng Vật tư- TBYT, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

- Nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm trước khi chào giá có thể đến Bệnh viện để khảo sát vị trí lắp đặt cụ thể hoặc tham khảo bản vẽ sơ bộ kèm theo.

- Các nội dung khác sẽ thống nhất khi thương thảo, ký kết hợp đồng.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Không tạm ứng.

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản 100%.


- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 120 ngày kể từ ngày bên mua nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: VT, VTTBYT.

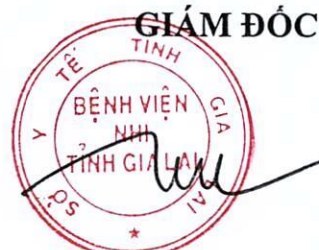

Đặng Hữu Chiến



Phụ lục

(Kèm Theo yêu cầu báo giá số 301/BVN-VTTBYT ngày 02/4/2025 của Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai).

Stt	Tên thiết bị	Cấu hình, thông số kỹ thuật	Đvt	SL
1	Hệ thống chuyên đổi X-quang kỹ thuật số	I. Yêu cầu chung - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. - Thiết bị mới nguyên 100%, được sản xuất năm 2024 trở về sau. - Hàng hóa đã được sử dụng thông dụng trên thị trường Việt Nam II. Yêu cầu về cấu hình: 1. Tấm nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số: 01 Cái 2. Pin dùng cho tấm nhận ảnh: 02 Cái 3. Bộ sạc pin : 01 Cái 4. Bộ hộp Control Box dùng để kết nối với tấm nhận ảnh: 01 Bộ 5. Phần mềm xử lý ảnh: 01 Phần mềm 6. Trạm xử lý hình ảnh: 01 bộ 7. Màn hình xử lý hình ảnh: 01 Cái 8. Bộ lưu điện UPS: 01 Cái III. Yêu cầu về tính năng kỹ thuật 1. Tấm Nhận Ảnh X-Quang Kỹ Thuật Số - Vật liệu nhấp nháy: CsI - Kích thước điểm ảnh: 140 μm - Ma trận điểm ảnh hoạt động: 3072x3072 pixels - Kích thước hoạt động: $\geq 430 \times 430$ mm - MTF @ 0.5lp/mm (Typ.): 84% - Dữ liệu ngõ ra: 16bit - Phương thức giao tiếp: Có dây hoặc Không dây - Dây cáp có thể tháo rời dễ dàng, kết nối bằng từ tính. - Thời gian 1 chu kỳ: 4.5 giây (Chế độ có dây)/ 5giây (Chế độ không dây) - Thời gian nhận ảnh: 1.5 giây (Chế độ có dây)/ 2 giây (Chế độ không dây) - Tự động lưu hình trên tấm: Lên đến 200 hình - Tích hợp chế độ điểm truy cập (Access Point Mode) - Tải trọng tối đa có thể chịu trên toàn bộ bề mặt tấm:	HT	1

		$\geq 400\text{Kg}$ - Tải trọng tối đa có thể chịu tại một điểm: $\geq 200\text{Kg}$ - Thời gian hoạt động của pin ở chế độ không dây: (Typ.) ≥ 300 lần chụp/7.5 giờ (Điều kiện: ngắt quãng 90 giây) - Công nghệ kháng bụi kháng nước IP68 hoặc tương đương. - Thay pin mà không cần tắt nguồn (Trong vòng 1 phút có thể tháo pin trong trạng thái tắt nhận vẫn hoạt động bình thường) 2. Pin dùng cho tấm nhận ảnh - Số lượng: 02 pin - Pin có thể tháo rời - Công suất: 36Wh (7.7V, 4725mAh) - Định mức điện áp: 7.7V - Thời gian sạc: ≤ 3 giờ - Thời gian hoạt động: (Typ.) ≥ 300 lần chụp / 7.5 giờ (Điều kiện: Ngắt quãng 90 giây) 3. Bộ sạc pin - Ngõ vào: 19V - Ngõ ra: 8.7V - Số lượng khe cắm: 02 - Bộ chuyển đổi AC cho bộ sạc pin: Đầu vào: 100 ~ 240VAC; Đầu ra: 19V/3.42A 4. Bộ hộp Control Box dùng để kết nối với tấm nhận ảnh - Nguồn điện đầu vào: AC100-240V, ~ 50/60 Hz - Nguồn điện đầu ra: DC24V, 2.1A - Dây nguồn AC: $\geq 1,5\text{m}$ - Kích thước (W $\times$ D $\times$ H): (125 $\times$ 255 $\times$ 109.8) mm 5. Phần mềm xử lý hình ảnh : - Công cụ phần Worklist: + Tìm kiếm và xem thông tin bệnh nhân. + Thêm mới/Chỉnh sửa/Xóa thông tin bệnh nhân. + Chế độ đăng kí cấp cứu. + Hỗ trợ tích hợp với dữ liệu cục bộ và MWL. - Công cụ phần Exam: + Kiểm tra thông tin bằng cách kiểm tra bộ phận chụp từ [Exam Order] + Cài đặt [Bản đồ cơ thể], [tư thế] và [Điều kiện phát tia].		
--	--	---	--	--



		+ Hình ảnh thu được thông qua tích hợp với DXD, Generator. + Xem trước hình ảnh. - Công cụ phần Review: + Xem ảnh. + Xử lý hậu kỳ cuối cùng của hình ảnh. + Cung cấp thông tin chụp. + Hỗ trợ các công cụ chỉnh sửa hình ảnh: - Phóng to/Thu nhỏ. - Toàn màn hình, Vừa với màn hình. - Xoay, Lật, Phản chiếu. - Cửa sổ / Cấp độ. - Biểu đồ. - Xoay. - Thêm văn bản. - Màn trập. - Đánh dấu. - Âm bản. - Mũi tên, Đường thẳng, Hình vuông, Hình elip, Thước kẻ, Góc. - Xử lý hình ảnh. - Chọn tất cả, Xóa. - Xuất hình ảnh (In, CD, USB). - Kết hợp hình ảnh. - Chấp nhận / Từ chối Hình ảnh. - Bố cục (1 x 1, 1x2, 2 x 2, 3 x 3). - Chuyển hình ảnh sang PACS. - Công cụ phần Setting: + Cài đặt hệ thống (Phiên bản SW, Quản lý tài khoản, Nhật ký sử dụng, Cài đặt ngôn ngữ) + Cài đặt giao diện (Dicom, Cột danh sách công việc / Tìm kiếm) + [Exam] (Giao thức, Thủ tục, Xử lý nâng cao) + [Thiết bị] (DXD, Generator, Cài đặt máy in) + [Máy chủ] ([MWL], [PACS], Cài đặt DB cục bộ). - Các công cụ khác: + Quản lý tài khoản người dùng, Đăng nhập + Cửa sổ trạng thái máy chủ / PC / DXD + Tập Hình ảnh, Quản lý Tự động Cơ sở dữ liệu + Hình ảnh dựa trên DICOM + Cấu hình và tích hợp máy chủ [PACS] 6. Trạm xử lý hình ảnh: - Hãng sản xuất: HP hoặc Dell hoặc tốt hơn	
--	--	--	--

		- Cấu Hình phần cứng chi tiết. + Intel CORE I5 trở lên + Bộ nhớ: ≥ 16 Gb + Lưu trữ: ≥ 500 Gb 7. Màn Hình xử lý hình ảnh - Kích thước hiển thị 21.5inch trở lên - Độ phân giải: 1920 x 1080, full HD trở lên 8. Bộ lưu điện UPS - Bộ lưu điện UPS 220V - Công suất: 2200 VA IV. Yêu cầu khác 1. Chất lượng hàng hóa: - Hàng mới 100%, còn nguyên đai, nguyên kiện. - Có giấy chứng nhận xuất xứ sản phẩm: CO (bản sao). - Có giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm: CQ (bản sao). - Có đầy đủ chứng từ nhập khẩu: Tờ khai hải quan, Invoice, Packing list, Vận đơn. 2. Chính sách bảo hành, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật: - Thời gian bảo hành: + Đối với Hệ thống chuyển đổi X-quang kỹ thuật số, Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số: 36 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng. + Đối với Máy tính, Pin, Bộ sạc, Bộ lưu điện UPS bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng. - Thời gian bảo trì và hỗ trợ sửa chữa không thay thế: trong suốt thời gian sử dụng thiết bị.		
2	Màn hình cảm ứng NX3 (Touch Monitor assy, NX3 r2.0 Elite)	Part Number: 11361357 Trọng lượng: 1.960 Kg Kích thước đóng gói: 41.5cm x 36cm x 12.5cm Tương thích: NX3 Elite VB20 sử dụng cho máy siêu âm chuyên tim (Model: Ecuson NX3 Elite; hãng/nước sản xuất: Siemens/ Hàn Quốc)	Bộ	1

Phụ lục 2

(Kèm theo yêu cầu báo giá số 304/BVN-VTTBYT ngày 02/4/2025 của Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai)

Mẫu báo giá

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

Stt	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Hãng/nước chủ sở hữu	Hãng/nước sản xuất	Năm sản xuất	Số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu	Số lượng	Đơn giá (Có VAT VND)	Thành tiền (VND)
1	Thiết bị A								
2	Thiết bị B								
n	...								
Tổng cộng:									

(Đề nghị nhà thầu gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.



....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,
nhà cung cấp**
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

